Traitement des endoscopes souples dans les laveurs-désinfecteurs AdaptaScope (ASP, Johnson & Johnson)

1. Réception des endoscopes en zone sale

Les endoscopes sales arrivent dans les bacs avec l'inscription « contaminated » (sur le rond orange)

Mettre le matériel de protection :

- Masque
- Bonnet et cheveux attachés sous le bonnet
- Lunettes ou masque avec protection faciale
- Sur-blouse de travail imperméable
- Gants à manches longues

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

2. Préparation de l'endoscope

Enlever la protection plastique du bac
Débrancher les boutons et caoutchoucs aux extrémités de l'endoscope

Mettre l'endoscope sous pression :

a. Connecter le test d'étanchéité sur l'endoscope
b. Connecter le raccord sur la pompe
c. Allumer la pompe
d. Placer l'endoscope dans le bac contenant la solution désinfectante-détergente

3. Contrôle d'étanchéité de l'endoscope

Actionner les poignées de commande pour déceler d'éventuelles fuites.

Si aucune fuite n'est visible :

a. Sortir de l'eau le connecteur (endroit où le test d'étanchéité est branché sur l'endoscope)
b. Débrancher le raccord sur l'endoscope
c. Débrancher le raccord sur la pompe
d. Arrêter la pompe

4. Pré-lavage de l'endoscope

Brosser avec un écouvillon les valves, les bouchons et les embouts, puis les mettre dans le panier ad hoc

Brosser les canaux selon les instructions du fournisseur
Laver l'extérieur de l'endoscope (tube d'insertion, poignées de commande…)

Une fois le pré-lavage terminé, placer l'endoscope dans le bac intermédiaire et rincer l'endoscope avec l'eau du robinet pour enlever un maximum de la solution désinfectante-détergente

Pour les endoscopes PENTAX, mettre la protection au niveau du doigt de lumière

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

5. Transport de l'endoscope dans le laveur-désinfecteur

Chargement de la **cuve de gauche**

Main gauche : poignée de commande et connecteur
Main droite : tube d'insertion

Chargement de la **cuve de droite**

Main gauche : tube d'insertion
Main droite : poignée de commande et connecteur

6. Branchement de l'endoscope dans le laveur-désinfecteur

Introduire le tube d'insertion dans le tube hélicoïdal
Positionner l'endoscope afin de réduire les points de contacts

Mettre les connexions en respectant l'ordre indiqué sur la machine :

	Séparateur de canal
Rouge	Test d'étanchéité
Jaune	Air
Bleu	Eau
Orange	Biopsie
Marron	Aspiration
Blanc	Canal supplémentaire 1
Bleu	Canal supplémentaire 2

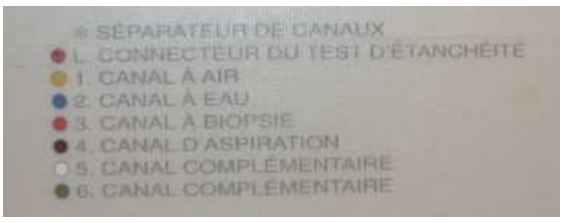

Raccorder une connexion à la fois

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

Connecter le raccord dans la machine en vous référant au code couleur

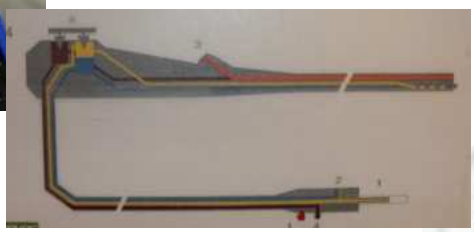

Connecter ensuite le raccord à l'endoscope en vous référant au schéma sur la machine

Une fois que le test d'étanchéité, les canaux et le séparateur de canal sont connectés, placer le panier avec les valves, les bouchons et les embouts dans la cuve

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

7. Démarrage du cycle en laveur-désinfecteur

Enlever les gants de protection

Se désinfecter les mains à l'aide de la solution alcoolique

Programmation du laveur-désinfecteur

Se placer dans le menu « RUN »
Si menu d'état du cycle, appuyer sur le bouton « FONCTION »
Choisir la fonction « CHOIX DU CYCLE »
Choisir la cuve utilisée « DROITE » ou « GAUCHE »
Choisir « PROG. INTENSIF »

Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « ACTIVER », entrer le numéro, appuyer sur « ENTRER »)

Entrer le numéro de l'endoscope à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « ACTIVER », entrer le numéro, appuyer sur « ENTRER »)

Entrer le numéro de séjour du patient à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « ACTIVER », entrer le numéro, appuyer sur « ENTRER »)

Fermer la porte
Choisir « DEMARRER », le cycle commence automatiquement

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

8. *Sortir l'endoscope du laveur-désinfecteur*

Se désinfecter les mains avec la solution alcoolique avant de manipuler l'endoscope

Appuyer sur « FONCTION »
Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du code barre
Appuyer sur « FONCTION » pour atteindre le menu « RUN »

Ouvrir la machine à l'aide de la pédale
Arrêter la pression sur la pédale quand le carré « fermeture machine » apparaît sur l'écran

Prendre le panier avec les valves, bouchons et embouts

En renversant le panier, mettre les valves, bouchons et embouts dans le bac de transport

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

Déconnecter tous les canaux
Mettre les extrémités des connections à l'extérieur de la cuve

Sortir l'endoscope de la cuve
Cuve droite : poignée de commande et connecteur à la main droite et tube d'insertion à la main gauche
Cuve gauche : poignée de commande et connecteur à la main gauche et tube d'insertion à la main droite

Mettre l'endoscope dans le bac de transport

Amener le bac de transport au niveau des rouleaux de transports

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.

Document établi en collaboration avec :

Endoscopie et Hôpital de jour
Rue du Bugnon - BH 07
1011 Lausanne

Service de Médecine
Préventive Hospitalière
Rue du Bugnon - BH 19
1011 Lausanne

Rotzenbuehlstrasse 55
8957 Spreitenbach
Tél: 056 417 33 33

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.